Application Note

MT8870Aアプリケーション デバッグログファイルの取得

はじめに

このアプリケーションノートでは、MT8870Aデバッグログファイルを取得し、分析のためアンリツに送信していただく方法を説明します。
テスト対象の機器がコマンド（CombiViewまたはリモートプログラミング）に応答しない、期待したフォーマットで結果が提供されない、あるいは機器が円滑に機能しないといった場合には、デバッグログが必要になることがあります。
ログファイルを取得するには、CombiViewや、WindowsのエクスプローラでのFTPコマンドラインを使用します。

CombiViewでログファイルを取得する

1. “Tools”＞“Download Debug Log”を選択します。

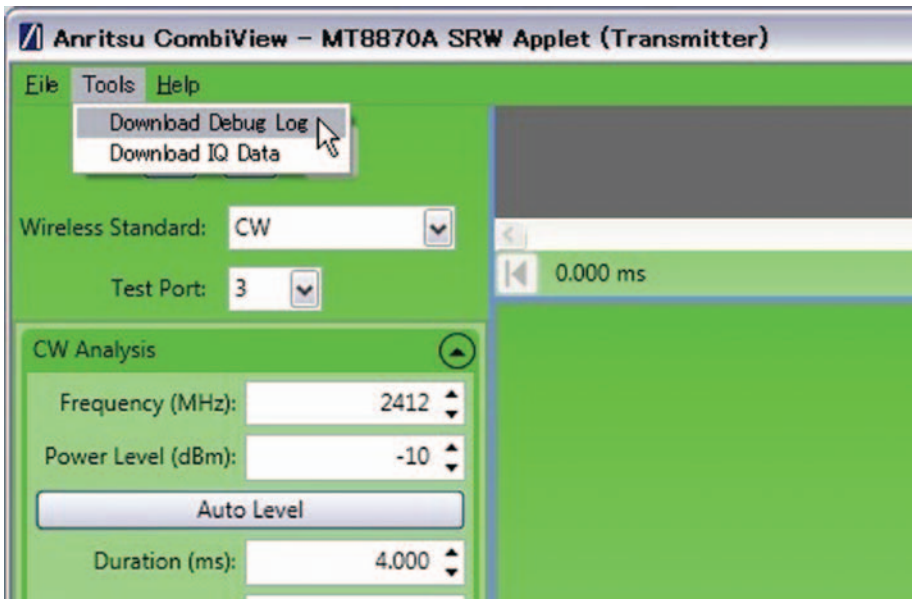

＜図1. Download Debug Log＞

2. テキストファイルの名前と場所を選択し、[Save]をクリックします。

3. 分析のため、ログファイルをアンリツ担当営業まで送信してください。
   注：[Save]をクリックしてから、ファイルが生成されるまでに数秒かかる場合があります。

FTPを使用してログファイルを取得する

1. Windowsでエクスプローラを開きます。

2. アドレス行に“ftp://”とタイプし、続けてモジュールのIPアドレスを入力します。
   （例：ftp://172.30.1.234）

3. ユーザ名およびパスワードの入力を求められますので、以下の情報を入力します。
   ・ユーザ名：“MT8870A”
   ・パスワード：“anritsu”

4. エクスプローラに4つのフォルダが表示されるので、そのうちの［Log］フォルダを開きます。

5. このフォルダの内容（“applog”および“applog.1”）をコピーし、分析のためアンリツ担当営業まで送信してください。

Anritsu

お見積り、ご注文、修理などは、下記までお問い合わせください。記載事項は、おことわりなしに変更することがあります。

アンリツ株式会社 http://www.anritsu.com

本社	〒243-8555 神奈川県厚木市恩名 5-1-1	TEL 046-223-1111
厚木	〒243-0016 神奈川県厚木市田村町8-5	
	計測器営業本部	TEL 046-296-1202 FAX 046-296-1239
	計測器営業本部 営業推進部	TEL 046-296-1208 FAX 046-296-1248
	〒243-8555 神奈川県厚木市恩名 5-1-1	
	ネットワークス営業本部	TEL 046-296-1205 FAX 046-225-8357
新宿	〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-14-1 新宿グリーンタワービル	
	計測器営業本部	TEL 03-5320-3560 FAX 03-5320-3561
	ネットワークス営業本部	TEL 03-5320-3552 FAX 03-5320-3570
	東京支店(官公庁担当)	TEL 03-5320-3559 FAX 03-5320-3562
仙台	〒980-6015 宮城県仙台市青葉区中央4-6-1 住友生命仙台中央ビル	
	計測器営業本部	TEL 022-266-6134 FAX 022-266-1529
	ネットワークス営業本部東北支店	TEL 022-266-6132 FAX 022-266-1529
大宮	〒330-0081 埼玉県さいたま市中央区新都心4-1 FSKビル	
	計測器営業本部	TEL 048-600-5651 FAX 048-601-3620
名古屋	〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅3-20-1 サンシャイン名駅ビル	
	計測器営業本部	TEL 052-582-7283 FAX 052-569-1485
大阪	〒564-0063 大阪府吹田市江坂町1-23-101 大同生命江坂ビル	
	計測器営業本部	TEL 06-6338-2800 FAX 06-6338-8118
	ネットワークス営業本部関西支店	TEL 06-6338-2900 FAX 06-6338-3711
広島	〒732-0052 広島県広島市東区光町1-10-19 日本生命光町ビル	
	ネットワークス営業本部中国支店	TEL 082-263-8501 FAX 082-263-7306
福岡	〒812-0004 福岡県福岡市博多区榎田1-8-28 ツインスクェア	
	計測器営業本部	TEL 092-471-7656 FAX 092-471-7699
	ネットワークス営業本部九州支店	TEL 092-471-7655 FAX 092-471-7699

再生紙を使用しています。

計測器の使用方法、その他については､下記までお問い合わせください。

計測サポートセンター

TEL: 0120-827-221、FAX: 0120-542-425
受付時間／9：00～12：00、13：00～17：00、月～金曜日(当社休業日を除く)
E-mail: MDVPOST@anritsu.com

● ご使用の前に取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 1207

■本製品を国外に持ち出すときは、外国為替および外国貿易法の規定により、日本国政府の輸出許可または役務取引許可が必要となる場合があります。また、米国の輸出管理規則により、日本からの再輸出には米国商務省の許可が必要となる場合がありますので、必ず弊社の営業担当までご連絡ください。

■ 記載内容は2013年4月23日現在のものです。

No. MT8870A-J-F-4-(1.00) 公知 Referenced: 13000-00420 Rev. A ddcm/CDT